

样品名称：CS006092

=====

操作者	:		序列行	:	3
仪器	:	仪器 1	位置	:	样品瓶 2
进样日期	:	2015-1-15 9:03:03 下午	进样次数	:	1
			进样量	:	0 μ l



来自于序列的不同进样量！实际进样量：2 μ l

采集方法：D:\Public\20150115\DEF_LC 2015-01-15 20-43-12\5-90 6MIN.M

最后修改：2015-1-14 6:09:59 下午

分析方法：D:\PUBLIC\20150115\DEF_LC 2015-01-15 12-41-40\CJ-20150115.D\DA.M (10-80 5MIN.M)

最后修改：2015-1-15 3:22:23 下午

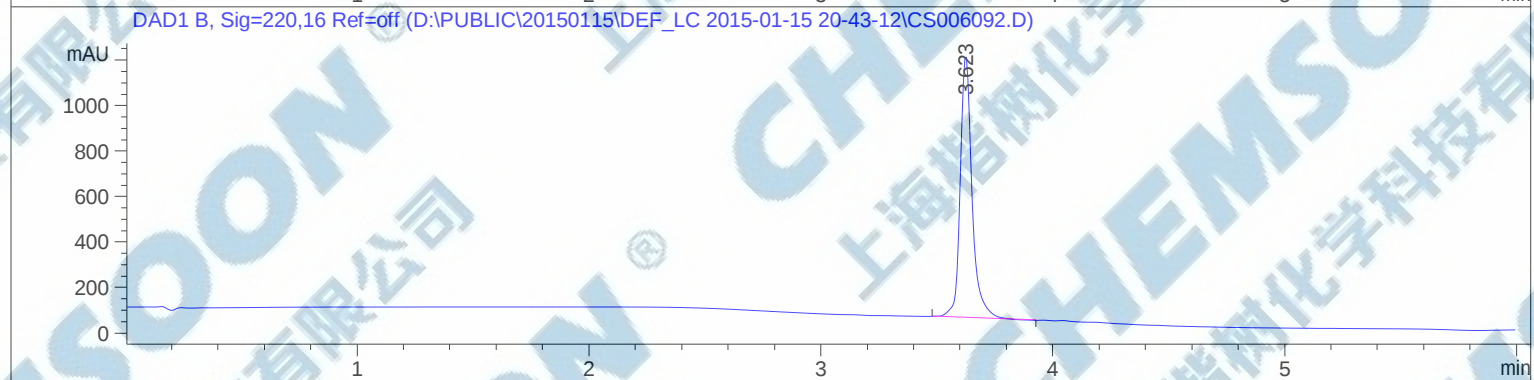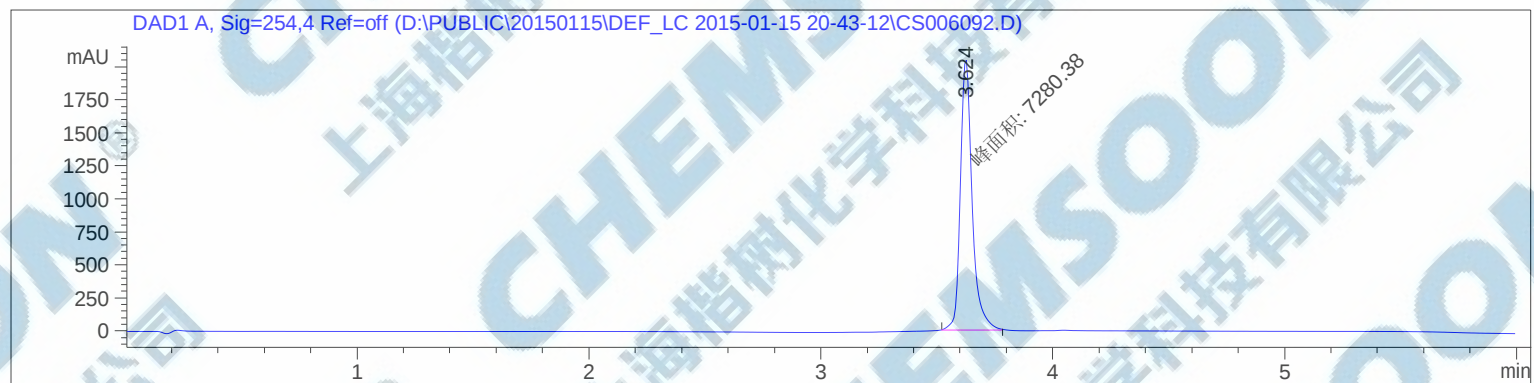

=====
面积百分比报告
=====

排序 : 信号
乘积因子 : 1.0000
稀释因子 : 1.0000
内标使用乘积因子和稀释因子

信号 1: DAD1 A, Sig=254,4 Ref=off

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	3.624	MM	0.0587	7280.38086	2065.77539	100.0000

总量 : 7280.38086 2065.77539

信号 2: DAD1 B, Sig=220,16 Ref=off

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	3.623	BV	0.0534	4098.05566	1155.30981	100.0000

总量 : 4098.05566 1155.30981

信号 3: MSD1 TIC, MS File

信号 4: MSD2 TIC, MS File

=====
*** 报告结束 ***
=====

MS Spectrum

*MSD1 SPC, time=3.671 of D:\PUBLIC\20150115\DEF_LC 2015-01-15 20-43-12\CS006092.D ES-API, Pos, Scan, Frag: 70, "scan"

Max: 511255



*MSD2 SPC, time=3.685 of D:\PUBLIC\20150115\DEF_LC 2015-01-15 20-43-12\CS006092.D ES-API, Neg, Scan, Frag: 70, "scan"

Max: 545024

